TANITA
健康をはかる

電子体温計
6193
取扱説明書

このたびは、TANITA電子体温計をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用いただきます前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いくださいますようお願い致します。

電子体温計の特長

●前回の検温値をメモリーし、ご使用前に1回だけ再表示する、前回値メモリー機能付。
●体温表示は大きな数字ではっきりデジタル表示。
●電源を消し忘れても、30分後に自動的に電源が切れる省エネ設計。
●体温終了を予告するブザー付。

各部の名称

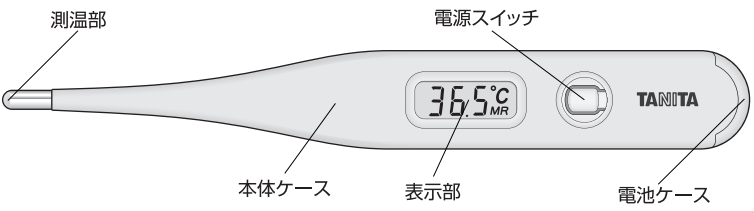

＜仕　様＞

種　　類……電子体温計　実測式　一般用　一部防浸形
名　　称……電子体温計 6193
検温範囲……32.0℃～42.0℃
表示範囲……32.0℃～42.0℃
使用環境……温度：10～40℃、湿度：30～85%
保管条件……温度：－20～60℃、湿度：95%以下
分 解 能……0.1℃
精　　度……±0.1℃
表　　示……液晶表示 3桁
電　　源……DC1.5V ⎓ (⎓：直流)、(アルカリボタン電池 LR41タイプ1個)
消費電力……0.09mW
電撃保護……内部電源機器 (：B形装着部)
電池寿命……約3年 (1日3回使用した場合)
寸　　法……約17(幅)×129(長さ)×8(厚さ)mm
質　　量……約10g(電池含む)
付 属 品……ハードケース、取扱説明書(保証書付)

★本製品はEMC規格 IEC 60601-1-2：2001に適合しています。EMC適合
★本製品はJIS T 1140：2005に適合しています。

製造販売元／シチズン・システムズ株式会社　医療機器認証番号 219ADBZX00030000 管理医療機器

◎本製品及び取り出した古い電池を廃棄する場合は、お住まいの市区町村の方法に従って処理してください。
◎取扱説明書に記載した以外の使用方法及び製造業社以外によって行われた修理、改造、再調整などについて、製造業社はその責任を負いません。

取扱い上のご注意

●人の測定以外には使用しないでください。
●本体ケースは曲げたり、落としたり、また絶対に分解しないでください。
●口中で測定するときは、測温部やその付近をかまないでください。
●高温や直射日光に当たるところ、湿気やホコリの多いところでの保管はさけてください。
●お子様が電池ケース部分をいじったり、なめたりしないようにしてください。電池ケースは、はずれないようにしてありますが、アルカリボタン電池を使用しておりますので、万が一にもお子様が飲みこまないようにご注意ください。
●ご使用後は、清潔にしてハードケースに保管してください。
●測温部の消毒には、消毒用アルコールをガーゼなどに含ませて拭き取ってください。また、本体ケースの汚れは乾いた柔らかい布で拭き取り、ひどい汚れは中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、洗剤をよく拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
●この電子体温計の電池ケースは防水構造ではありません。水滴や唾液などが入ると故障の原因となります。
●冬期間、または冷所に保管した場合は、あたたかいところに10分間ほどおいてからご使用ください。
●飲食や運動・入浴後は体温の変動が激しく、正確な測定ができないことがありますので検温は避けてください。

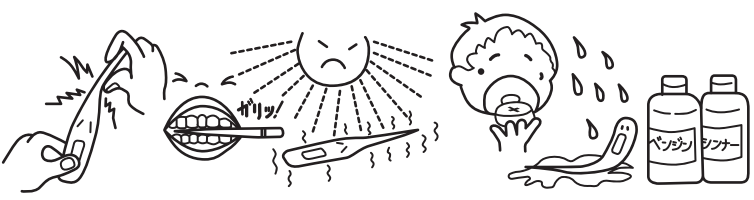

検査証：本製品は定められた検査に合格しております。

無料修理規定

1．取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2．保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
3．ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合は、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
4．保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
　イ．使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　ロ．お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
　ハ．火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
　ニ．一般家庭以外（例えば、業務用の長期間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷
　ホ．保証書の提示がない場合
　ヘ．保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5．保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6．保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

ご使用方法

●電源スイッチを押すとピーッという音とともに表示部に 88.8 と表示され、さらに電源スイッチを押し続けると前回の検温値が再表示されます。〈表示例〉 36.5
（初めてご使用のとき、または32℃未満の場合には ＿＿＿℃ と表示されます。）
電源スイッチをはなすと ーーー℃ 、 42.0℃ と連続表示され、最後に ＿＿＿℃ が表示（℃部分が点滅）されます。この表示が出たら検温ができます。

●舌下あるいは、わきの下で検温してください。検温終了の予告ブザーがピーッピーッピーッと鳴ったら、そのままの状態で３分以上待ってから体温計を取り出して体温を確認してください。

●体温を確認したら必ず電源スイッチを押して OFF にしてください。ピーッという音とともに表示部の文字や数字が 全部消えます。

●検温終了の予告ブザーは１回の検温で１回しか作動しません。

警告ブザーについて

電子体温計は測温部の先端で集中的に温度をつかまえる性質がありますので、先端がピッタリふれることが最も重要です。ブザーは体温計の温度上昇が30秒間（0.1℃）止ると鳴る設計になっています。このブザーを検温終了の目安としてご利用ください。時によって35.0℃未満でブザーが鳴ってしまうことがあります。これは測温部がわきの下にピッタリ密着していなかったり、あてる場所が違っている場合に起こる現象です。正しい検温方法でもう一度計り直してください。それでも鳴ってしまう場合は舌下検温をおためしください。

正しい検温方法

●わきの下での検温
・あらかじめ乾いた布でわきの下の汗をよく拭きとり、測温部をわきの下の中心部に、下から押しあげるようにして当て、わきをしっかり閉じて密着させます。

・検温中は測温部がズレないように注意してください。

●舌下での検温
・測温部を口の横から舌下のつけ根部分に差し入れ、舌で密着させて口を閉じます。
・密着させたままで、すき間をつくらないよう注意してください。

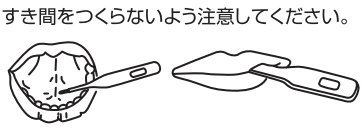

●飲食や運動・入浴後は体温の変動が激しく、正確な測定ができないことがありますので検温は避けてください。

●より正確に体温を測定する時は、病院などでは、舌下検温に６分以上、わきの下の検温に10分以上かける必要があるといわれています。

電池の取扱い方法

●表示部の □ が点灯しはじめたら、電池の交換時期です。新しい電池と交換してください。

●電池は、アルカリボタン電池 LR41 です。（百貨店、電気店、時計店、カメラ店などで販売しています。）

●電池寿命は一日３回の使用で、約３年間です。（お買い上げの際に、すでにセットされている電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短いことがあります。）

電池の交換方法

●⊖ドライバーを本体ケースの裏面にあるフック穴の中に差し込んで電池ケースをはずします。

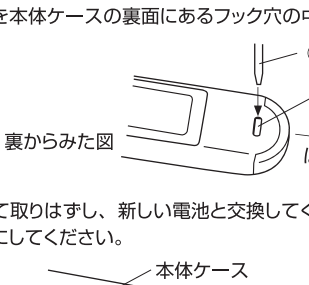

●電池を滑らして取りはずし、新しい電池と交換してください。交換のとき極性＋、－を間違えないようにしてください。

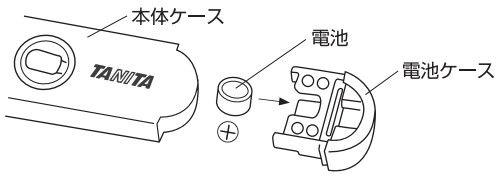

●電池を取りつけたときブザーが鳴ったり、誤表示することがありますが故障ではありません。電源スイッチを押し直せばすぐ正しい表示になります。

アフターサービスについて

1. 保証書について
保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間です。（電池は保証外です）

2. 修理を依頼されるとき
●保証期間中は弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上保証書を添えて製品をお送りください。
●保証期間が過ぎているときは弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合はご希望により有料修理させていただきます。

3. ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

©2007 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174−8630 東京都板橋区前野町1−14−2	☎03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577−0013 東大阪市長田中1−3−15	☎06(6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460−0002 名古屋市中区丸の内2−19−20	☎052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816−0082 福岡市博多区麦野4−2−6	☎092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒983−0852 仙台市宮城野区榴岡1−6−8	☎022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒007−0834 札幌市東区北34条東22−1−35	☎011(786)5611(代表)

ホームページアドレス http://www.tanita.co.jp

お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-133821
受付時間／9：00〜18：00（土・日・祝祭日は除く）
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

－切 り と り 線－

保 証 書

販売店様へ
ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。
※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品名	電子体温計　6193	
保証期間	本体　お買い上げ日より1年間	
お買い上げ日	年　月　日	
販売店	住所・店名 ㊞	
	電話　（　）	
お客様	ご住所	
	お名前　様	
	電話　（　）	